ICS 27.100

F21

WUHV特高压

目　次

前言 …… II
1　范围 …… 1
[illegible]
包装、运输和贮存 [illegible]

逆变、中频变压器、倍压、测量及保护等部分组成，示意图见[illegible]

5.3.3 放电试验

耐受电压

瞬变电压试验

电压应能从零开始升压，连续平滑可调。在额定输出电压的 10%~100%范围内，直流输

在额定输出功率下，装置连续工作时间不应小于 30 min。

4.1.3 极性

过压保护功能

压保护功能

在过电压整定值的（±5%）内。

要求。

6.4.3 放电试验

将被检装置的直流高压输出端经限流电阻接至放电球隙，调整放电球隙的放电电压为被检装置的[illegible]

PV——直流标准电压表。

[illegible]

[illegible]

U_N ——被检装置的额定输出电压。

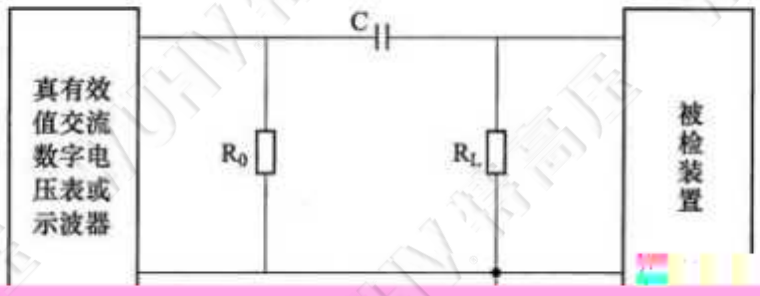

7.2 型式试验

[illegible]之一的，装置应进行型式试验：

a) 新产品鉴定投产前；

[illegible]

[illegible]允许误差；

产品生产标准号

包装

[illegible]

9.3 贮存

包装完好的装置应满足 GB/T [illegible]480 规定的贮存运输[illegible]

DL/T 848.1—2019
代替 DL/T 848.1—2004

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
高压试验装置通用技术条件
第 1 部分：直流高压发生器
DL/T 848.1—2019
代替 DL/T 848.1—2004

*

中国电力出版社出版、印刷、发行
（北京市东城区北京

中国电力百科网网址 电力标准信息
155198.2308