


JJF


中华人民共和国国家计量技术规范

JJ 1264—2010

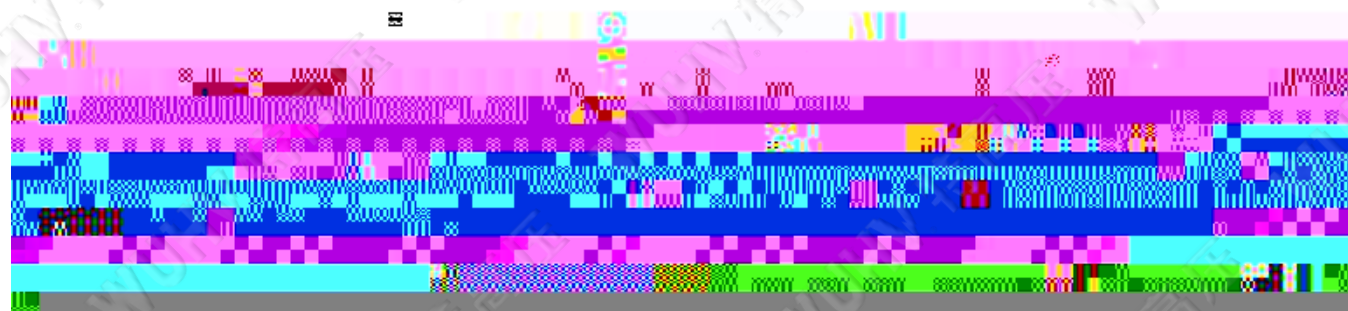

本规范主要起草人：



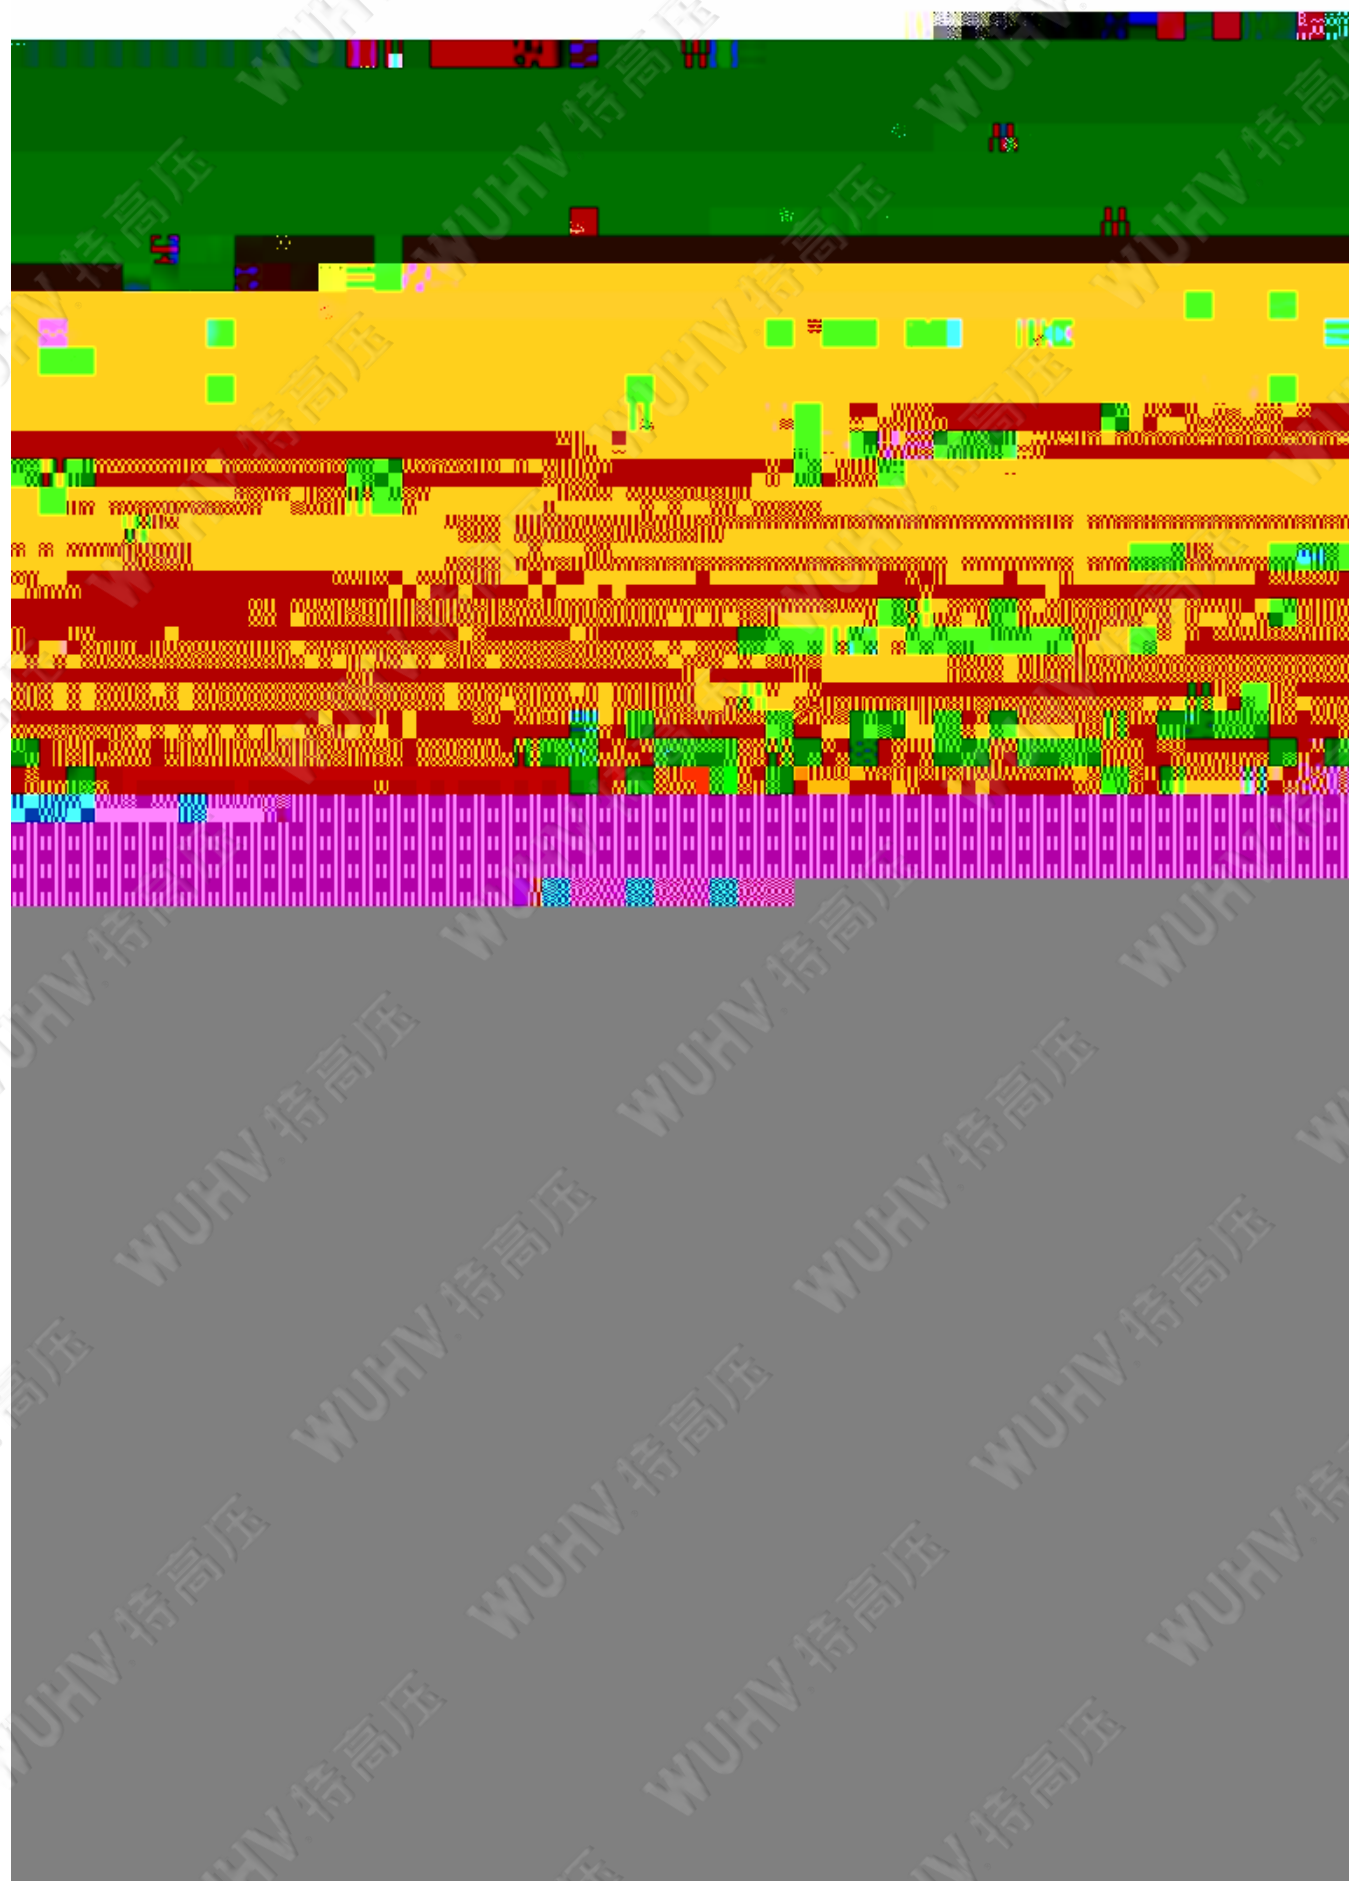

c) 校准点的选取

1) 工作电流范围为 $(1 \sim 120)\% I_n$ 的电流互感器负荷箱，应选取额定电流的 1%、100%、120% 等校准点进行校准；电流范围为 $(5 \sim 120)\% I_n$ 的负荷箱，应选取额定电流的 5%、100%、120% 等校准点进行校准。对于工作电流范围超过 $120\% I_n$ 的负荷箱，还应增加与最大电流工作范围对应的校准点。

2) 工作电压范围为 $(20 \sim 110)\% U_n$ 的电压互感器



JJF 1264—2010

附录 B 推荐的校准证书中文格式

