




温 度	20℃	地点	石家庄市鹿泉区上庄大街河北省计量院 9 栋 403 室
相对湿度	52%	其他	/
校准使用的主要计量标准器：			

名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
模拟大功率直流有源标准电阻器	电流 1A; 电阻 1mΩ ~ 60 Ω	0.02 级	DCZT17-JZ0296	2023年02月15日

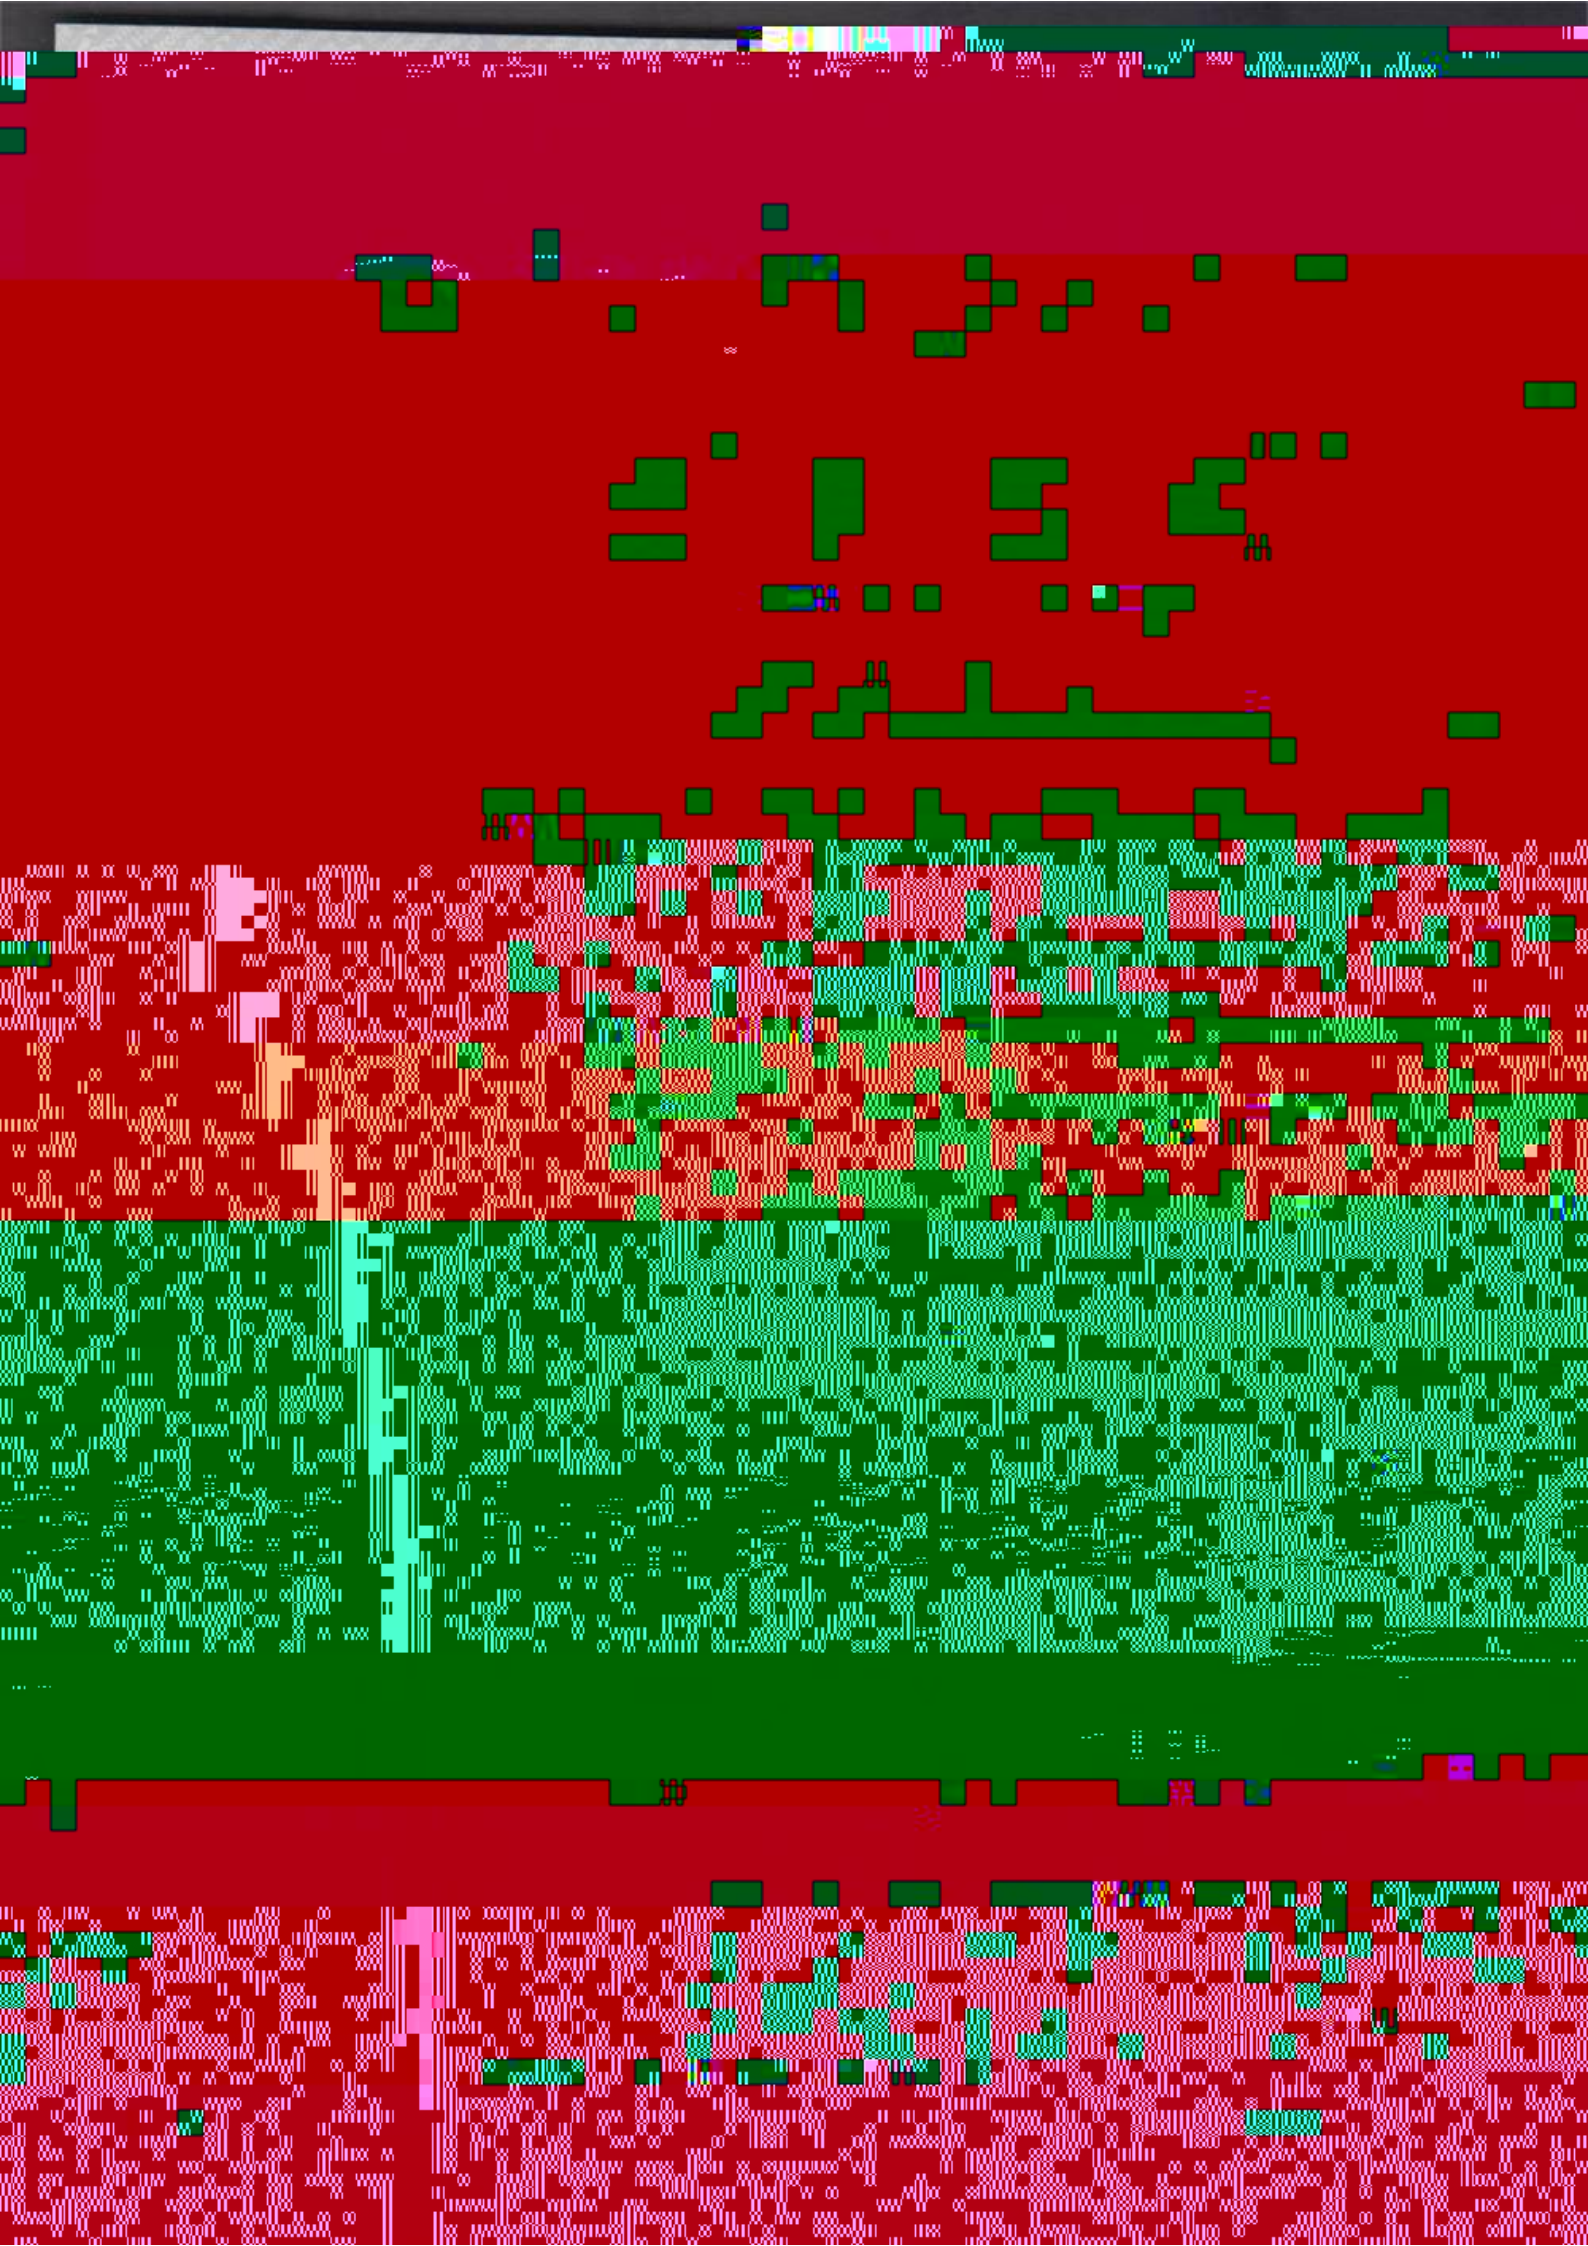