



湖北电力工程试验研究院有限公司

湖北电力工程试验研究院有限公司

证书编号: 2026DW043000059
Certificate No.

委 托 方

中国石化(新疆)石油工程有限公司

Name of instrument

交流额定载力按开关参数测试仪

制 造 厂 商
Manufacturer


武汉特高压电力科技有限公司

型 号 / 规 格
Type/Specification

UHV-3000

器 具 编 号
Serial No.

2603045

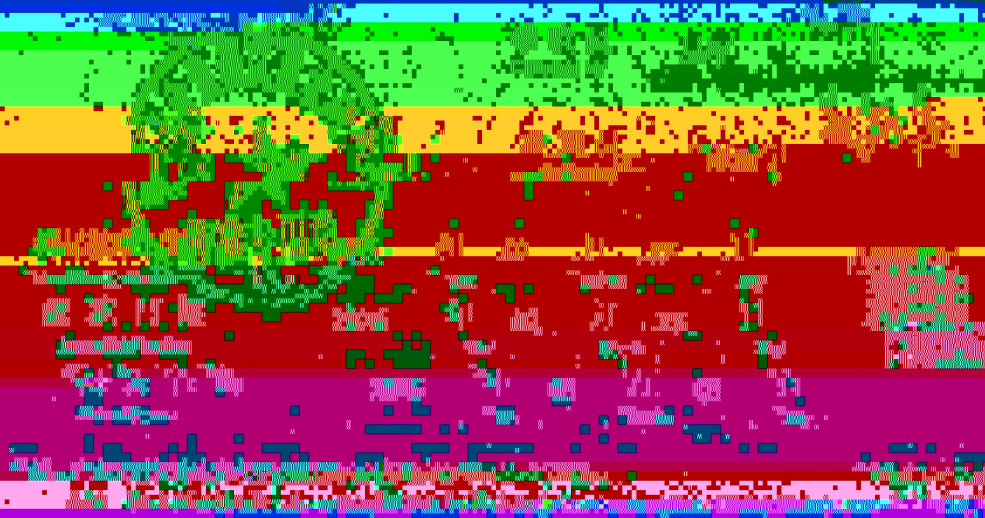


扫描全能王 创建

湖北省计量测试技术研究院

证书编号: 202001044000240

校准证书
校准日期: 2020年04月04日
校准地点: 湖北省计量测试技术研究院
校准人员: 王强、李强
校准设备: 数字式万用表
校准标准: JJG 1001-2011
校准结果: 符合规定要求
校准有效期: 2021年04月04日
校准证书编号: 202001044000240

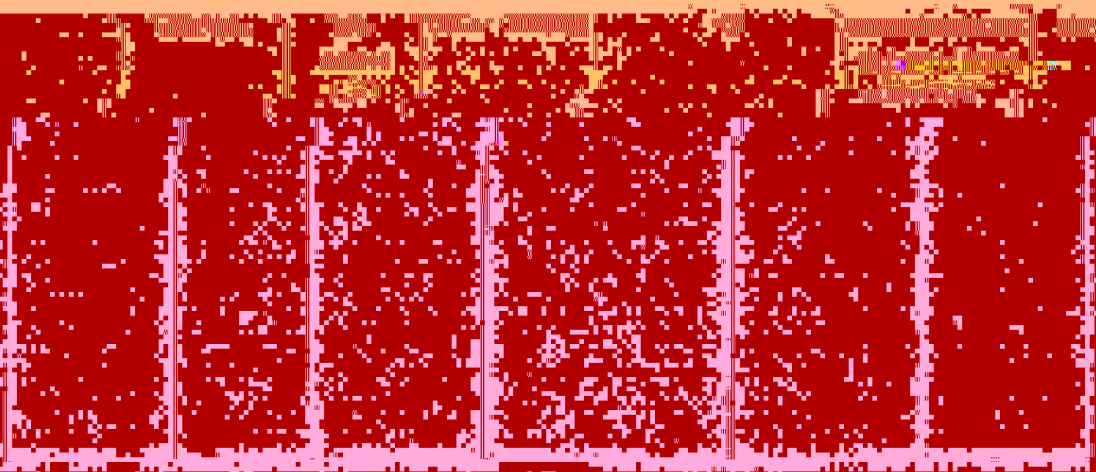

校准证书

Environmental condition and Place for the Calibration

地点: 湖北省计量测试技术研究院

Site

温度: 19.8℃

Temperature

相对湿度: 35 %

R.H.

其它: —

Other

压力: 101.3 kPa

Pressure

原始记录编号: 202001044000240

Record No.

签字: 王强

Signature

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.

校准证书编号: 202001044000240

Calibration Certificate No.



扫描全能王 创建

