

湖北省计量测试技术研究院


Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

证书编号

号

Certificate No.

● 本院是政府计量行政管理

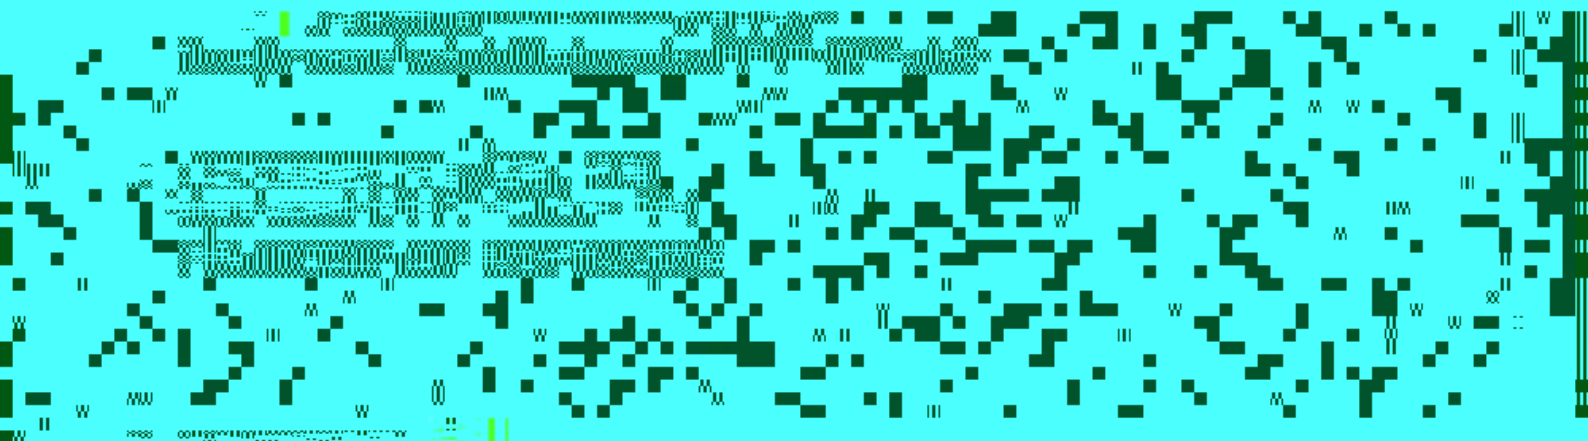

湖北

显示值(W)

Pa	1100.28	549.88	550.65
Pb	1100.28	549.78	550.67
Pc	1100.20	549.69	550.65

测量不确定度

$U_{rel}=0.05\%(k=2)$ $U_{rel}=0.05\%(k=2)$ $U_{rel}=0.05\%(k=2)$

8、三相功率

设定值

标准值(W)

显示值(W)

测量不确定度

电压

电流

功率因数

3×220/380V

3×5A

1.0

3300.57

3300.87

$U_{rel}=0.05\%(k=2)$

0.5(L)

1648.95

1649.35

$U_{rel}=0.05\%(k=2)$

0.5(C)

1651.83

1652.00

$U_{rel}=0.05\%(k=2)$

以下空白