◆

◆

1 液晶屏
自定义
✓静置 05min
间隔 02min
搅拌 10s
停升电压60kV
打压次数 6次
2 功能键

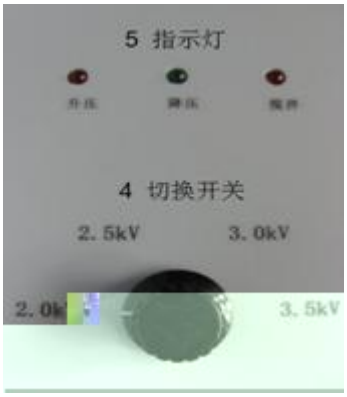
5 指示灯
4 切换开关
2.5kV
3.0kV
3.5kV

7 温湿度传感器

9 电源插口
8 地线柱

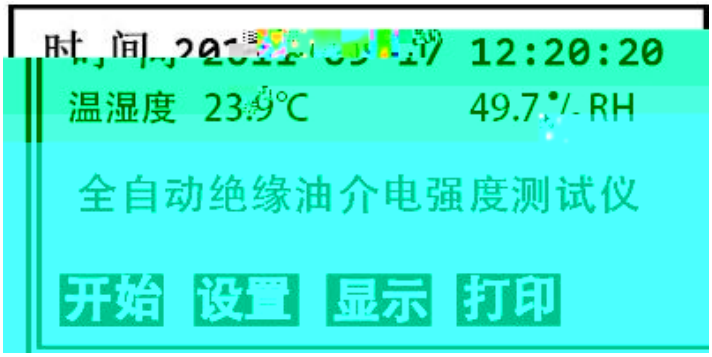
12:20:20
温湿度 23.9℃
49.7%RH
全自动绝缘油介电强度测试仪
开始
设置
显示
打印

√GB1986
时间设置
GB2002
数据标定
自定义设置
选择
返回
确认

GB1986

杯位选择
●1号杯 √
2号杯 √
3号杯 √
选择
×
√
确认

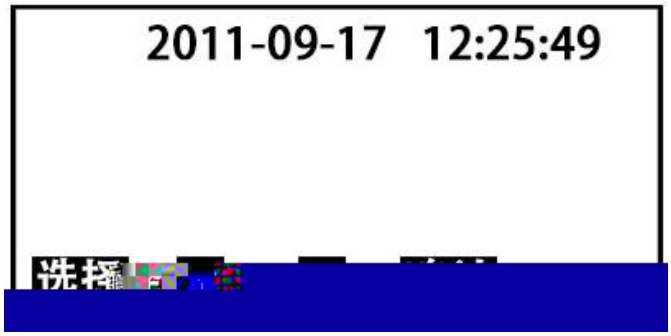
2011-09-17 12:25:49
选择

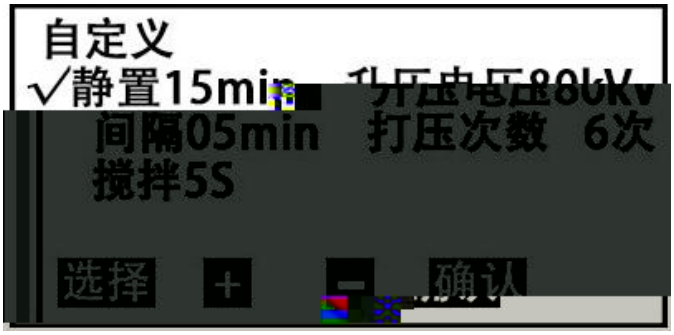
自定义
√静置15min
间隔05min
打压次数 6次
搅拌5S
选择
+
确认

2号杯
平均00.0kV
[1] 00.0 kV
[4] 00.0 kV
[2] 00.0 kV
[5] 00.0 kV
[3] 00.0 kV
[6] 00.0 kV
测量时间 2011-10-24 22:09
选择
打印
确认