

¿Basta?

—


C


0% ~

—

1
2
3
4
5

6
7
8

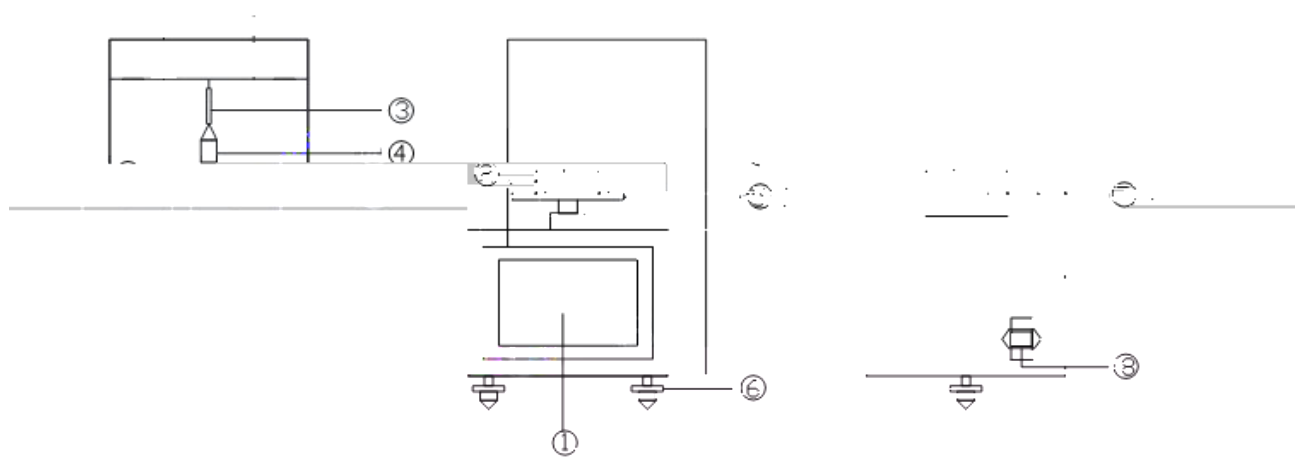

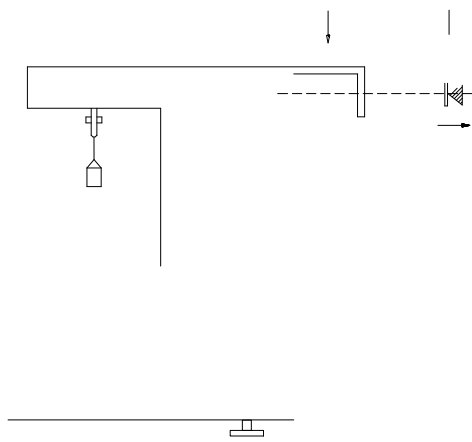

砵码标定

砵码重量:

克

等效张力:

毫牛顿/毫米

若显示重量与实际重量相差大，按砵码标定按钮重新标定。

清零

砵码标定

参数设置

铂丝半径

0.297

毫米

铂环半径

9.856

毫米

重液密度

1.000

克/毫升

轻液密度

0.875

克/毫升

打印开关

OFF

保存按钮


2.1 0.30 mm

2.2 9.8 mm


2.3 1.000

2.4 0.875

“ ” “ ”

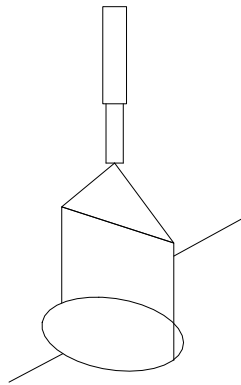


3.2 ‘ , ’

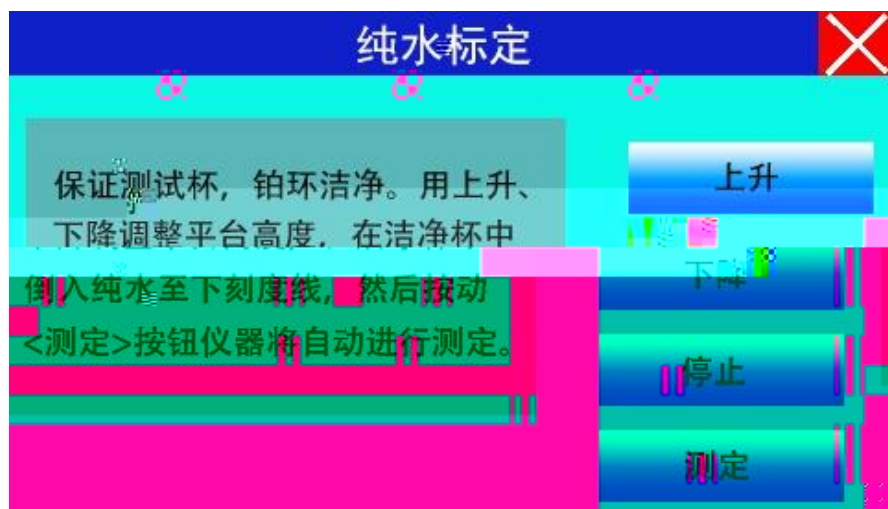

3.3 ‘ , ’ ‘ , ’ ‘ , ’



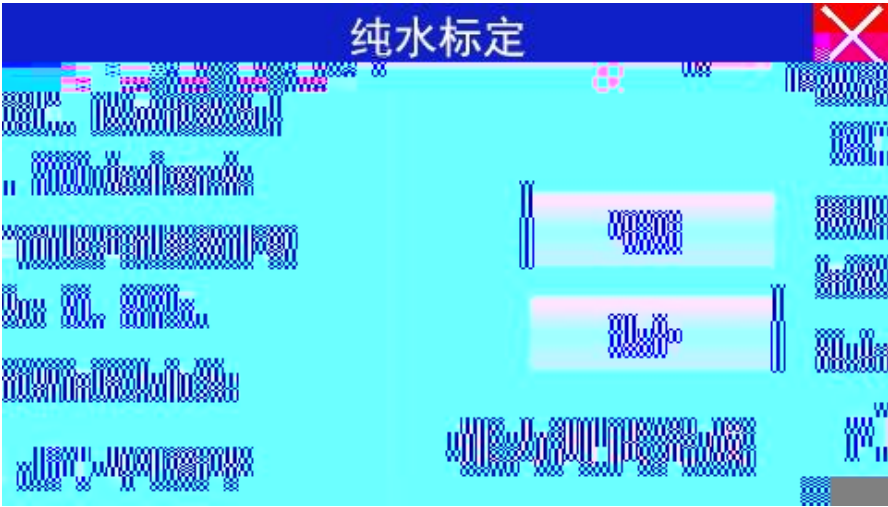

‘ ’ ‘ ’

3.4 GB6541 5.3 71 72 /
1.1 1.2 3.1

22

71 72 /

3.5 “ ”

4.

4.1 ‘ ’

样品测试

step1:

仪器将自动调整下降高度，
使其铂环浸入水中5毫米处。


step2:

当提示栏出现请加入测试样品时，
请缓慢地倒入测试样品，使其液
面达到测试杯上的刻度线，完成
后按<继续>按钮

停止

返回

继续

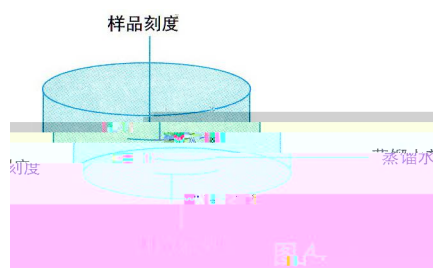

30

样品测试

当前重量 0.000 g

温度: 25.0 °C

(g)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

5

10

15

20

25

30 (s)

正在调整工作台位置

停止

返回

“ ”

x

—

—



ρ —

ρ —

—

—

—